

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 МАЯ 2008 Г. № 29

8/1895

(11.06.2008)

**О внесении дополнений и изменений в
постановление Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь
от 7 марта 2007г. № 14**

На основании Положения о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 « Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь », Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке применения знака поверки средств измерений и его формах, утвержденную постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 14 «Об утверждении инструкций о порядке применения знака утверждения типа средств измерений, знака поверки средств измерений, знака маркировки фасованных товаров и их формах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 92, 8/16245), следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Знак поверки - условный знак установленной формы, предназначенный для нанесения на средства измерений или их эксплуатационные документы по результатам их поверки, удостоверяющий соответствие средств измерений требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений.»;

1.2. в пункте 5 слова «невооруженным глазом изображения и всех его элементов» заменить словами «всех элементов знака поверки»;

1.3. в пункте 9 слова « и роторных пломб » заменить словами «, роторных или аналогичных пломб»;

1.4. приложение к данной Инструкции изложить в следующей редакции:

«Приложение к
Инструкции о порядке
применения знака
поверки средств
измерений и его
формах

Формы знака поверки средств измерений

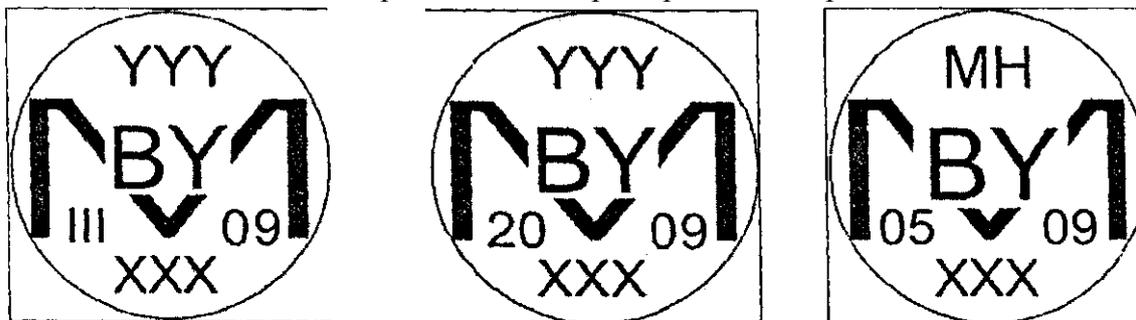


Рисунок 1. Изображение знака поверки для применения юридическими лицами ГМС

Обозначения: ВУ - международный код Республики Беларусь;

М - стилизованное обозначение знака поверки;

YYY - последние значащие цифры номера аттестата аккредитации поверочной лаборатории, проводившей поверку;

МН - шифр юридического лица ГМС, устанавливаемый Госстандартом;

XXX - индивидуальный шифр поверителя (цифро-буквенное обозначение);

III - квартал (от I до IV) проведения поверки (римскими цифрами);

09 - две последние цифры года применения поверительного клейма;

20 09 - год применения поверительного клейма;

05 - месяц (от 01 до 12) проведения поверки (арабскими цифрами)

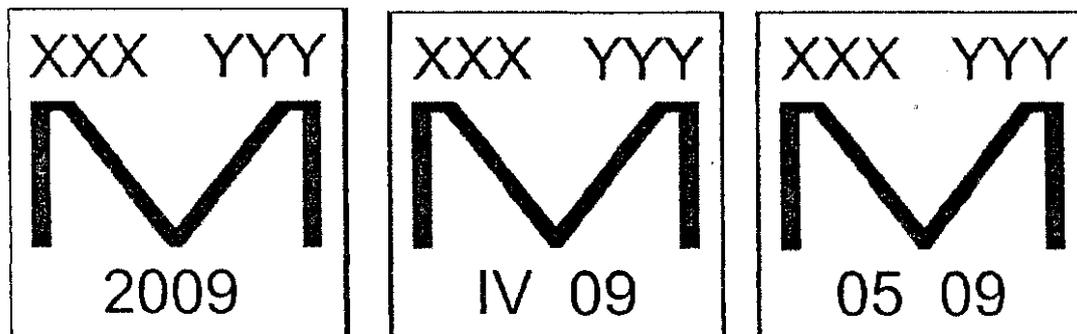


Рисунок 2. Изображение знака поверки для применения иными юридическими лицами

Обозначения:

М - стилизованное обозначение знака поверки;

YYY - последние значащие цифры номера аттестата аккредитации поверочной лаборатории, проводившей поверку;

XXX - индивидуальный шифр поверителя (цифро-буквенное обозначение);

IV - квартал (от I до IV) проведения поверки (римскими цифрами);

09 - две последние цифры года применения поверительного клейма;

2009 - год применения клейма;

05 - месяц (от 01 до 12) проведения поверки (арабскими цифрами).

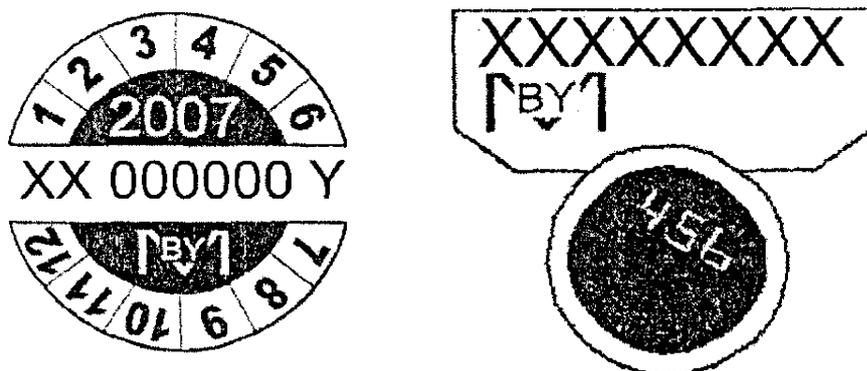


Рисунок 3. Изображение клейма - наклейки, роторной или аналогичной пломбы для применения юридическими лицами ГМС

Обозначения:

BY - международный код Республики Беларусь;

M - стилизованное обозначение знака поверки;

XX - шифр юридического лица ГМС, устанавливаемый Госстандартом;

XXXXXXXX — порядковый номер пломбы (8 знаков, арабскими цифрами);

Y - шифр поверителя или структурного подразделения поверочной лаборатории, применяющих знак поверки (буквенное обозначение от А до Я, кроме букв Ё, Й, Ы, Ь, Ъ);

2007 - год применения клейма-наклейки;

1-12 - месяц проведения поверки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.

Председатель

В.Н.Корешков